LevMed

Keeping Health Simple™

¡Ordene aquí! PRAXISDIENST Material Médico desde 1933

LevMed AllBrand™ ECG Electrode Belt

Ceinture d'électrodes ECG AllBrand™ LevMed

Cinturón de Electrodos ECG LevMed AllBrand™

Cintura con elettrodi ECG AllBrand™ di LevMed

EKG-Elektrodengürtel LevMed AllBrand™

LevMed AllBrand™ ECG-elektroderiem

LevMed AllBrand™ ECG Elektróda Öv

LevMed AllBrand™ EKG Elektrot Kemeri

Ζώνη Ηλεκτροδίων ΗΚΓ LevMed AllBrand™

حزام إلكترود تخطيط القلب LevMed AllBrand™

O Produto: Cinta Elétrodo ECG, da Empresa, LevMed AllBrand™

LevMed AllBrand™ EKG elektrodový pás

LevMed

Keeping Health Simple™

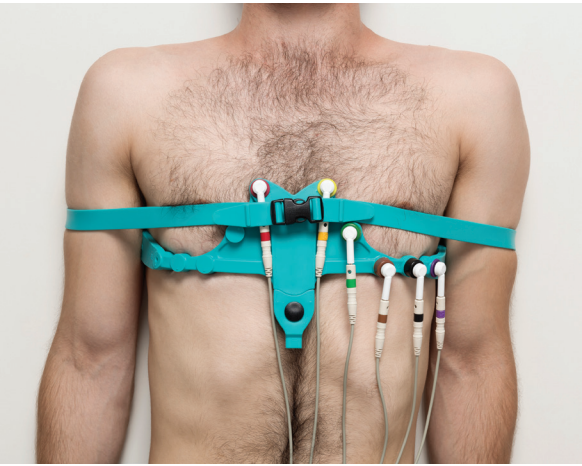

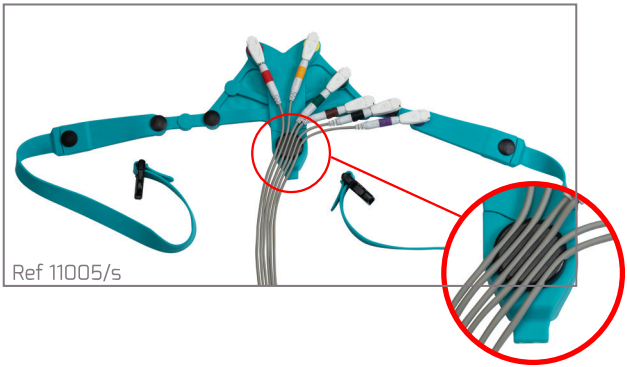

MD

LevMed

Keeping Health Simple™

INSTRUCCIONES DE USO
Cinturón de Electrodos ECG LevMed AllBrand™

Produto com Alças (Categoria nº 11005/h)

Produto com Alças (Categoria nº 11005/s)

Apenas Rx

Precaución:Lea la lista de instrucciones completa antes de usar el producto

Precaución:La ley federal (EE. UU.) restringe la venta de este dispositivo a un médico o por orden de este.

USO PREVISTO: El cinturón de electrodos de ECG LevMed AllbrandTM es un accesorio reutilizable diseñado para usarse con dispositivos de ECG para registros de ECG de reposo de 12 derivaciones a corto plazo para adultos y pediatría.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- No utilice este dispositivo para propósito alguno que no sea el uso previsto declarado.
- Retire el dispositivo antes de realizar la desfibrilación.
- El cinturón de ECG LevMed está diseñado para ser utilizado para registros de ECG en reposo, asegúrese de que el paciente esté relajado, acostado y quieto, sobre una superficie plana.
- Manténgase alejado de dispositivos que creen fuertes campos electromagnéticos.

CONTROINDICAZIONI

- No utilice el cinturón de ECG de LevMed sobre piel irritada o dañada.

EXPLICACIONES DE SÍMBOLOS

Precaución, consulte las instrucciones de uso

SN Número de serie

REF Número de catálogo

Fabricante

Fecha de fabricación

NON STERILE No estéril

RAEE- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

CE

Cinturón de Electrodos ECG LevMed AllBrand™

INSTRUCCIONES DE USO
1.DESCRIPCIÓN DEL APARATO
El cinturón de ECG LevMed AllBrandTM es un sistema de electrodos de ECG moldeados en una silicona hiperflexible que es similar a los electrodos precordiales de ECG V1-V6. El Cinturón es flexible y se puede estirar para adaptarse a todas las formas y tamaños del cuerpo, tanto para hombres como para mujeres. Cuando se ajusta al pecho, se estira a las proporciones requeridas y la distancia entre los electrodos se establece automáticamente. El Cinturón se puede conectar a cualquier cable de paciente de ECG estándar.

2. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Escanee el código QR aplicable para el proceso de aplicación del cinturón de ECG AllBrandTM:

Para AllBrand con Manijas (N.° de catálogo 11005/h)

Para AllBrand con Correas (N.° de catálogo 11005/s)

3. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Limpie el cinturón de ECG de LevMed con una toallita desinfectante después de cada paciente. Utilice únicamente desinfectantes específicos para su uso en dispositivos médicos
Precaución: No utilice desinfectantes que contengan alcohol.

GARANTÍA
La garantía de LevMed Ltd. se aplica a los componentes de silicona del cinturón de ECG durante un período de 12 meses a partir de la fecha de compra o 15 meses a partir de la fecha de producción, lo que sea más corto. Los cables, alambres internos, electrodos, piezas de plástico y otras piezas integradas en el cinturón de ECG están cubiertos por la garantía durante un período de 3 meses a partir de la fecha de compra o 6 meses a partir de la fecha de producción, lo que sea más corto. La garantía no se aplica a ningún accesorio suministrado.
Esta garantía no incluye ni cubre fallas de funcionamiento causadas por un uso irrazonable, incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento o del usuario, o daños causados por reparaciones no autorizadas o no calificadas.